INDICATIONS
Les pansements Lumiderm® 6000, dispositifs médicaux de classe IIb, sont indiqués pour la couverture des plaies post-chirurgicales, non infectées et légèrement à modérément exsudatives, notamment en chirurgie plastique et orthopédique.
La membrane Lumiderm® 6000 protège la plaie du desséchement aidant ainsi le processus de cicatrisation des plaies aiguës superficielles.
La membrane Lumiderm® 6000 est souple, très conformable et constitue une barrière antimicrobienne.
Les pansements Lumiderm® 6000 peuvent aussi être utilisés comme pansements de recouvrement secondaire.

DESCRIPTION
Lumiderm® 6000 est constitué d'une membrane stérile en mousse de polyuréthane microporeuse d'une épaisseur de 400 µm.
La surface en contact avec la peau contient une colle acrylique hypoallergénique
Les deux faces de la membrane présentent des microporosités différentes permettant :

- face interne, une légère absorption des liquides et exsudats
- face externe, des échanges gazeux (oxygène, gaz carbonique et vapeur d'eau) et une imperméabilité à l'eau

Les pansements Lumiderm® 6000 sont présentés dans un sachet papier unitaire stérile.
Lumiderm® 6000 ne contient pas de latex ni d'ingrédients d'origine animale.

PROPRIÉTÉS

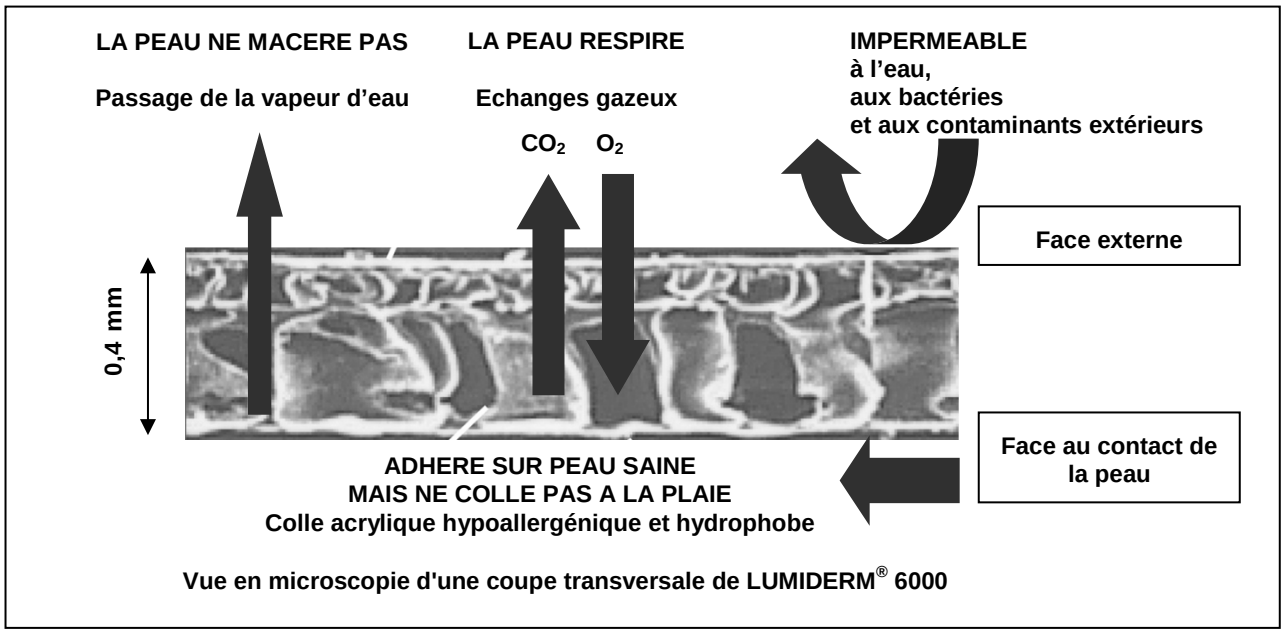

Vue en microscopie d'une coupe transversale de LUMIDERM® 6000

La porosité différentielle des deux faces de la membrane Lumiderm® 6000 permet de créer des conditions indispensables à la physiologie cutanée et au bon déroulement des différentes étapes de la cicatrisation des plaies, qu'elles aient été suturées ou non.
La plaie ne macère pas et reste parfaitement protégée de l'eau et des contaminants extérieurs.
De par la composition et la finesse de la membrane, Lumiderm® 6000 est souple, extensible mais résistant, très conformable anatomiquement et permet les mouvements.
De plus, grâce à la totale imperméabilité de la face externe de Lumiderm® 6000, le patient peut se laver ou prendre des douches modérées.
Enfin, l'adhésif acrylique est hydrophobe : il colle parfaitement à la peau saine autour de la plaie pendant plusieurs jours (jusqu'à sept jours) sans adhérer au lit de la plaie, siège d'une humidité physiologique.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser Lumiderm® 6000 sur des plaies profondes non suturées, ou sur des plaies très exsudatives.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- A usage externe uniquement.
- Les pansements Lumiderm® 6000 doivent être utilisés sous la surveillance d'un professionnel de santé, en cas de plaies infectées ou susceptibles de s'infecter.
- Retirer le pansement en présence d'un écoulement, de signes cliniques d'infection ou si le patient ressent une gêne inhabituelle.
- Une peau grasse ou trop humide peut nuire à la bonne adhérence de Lumiderm® 6000.
- Une sudation excessive de la peau environnant la plaie peut provoquer le décollement de Lumiderm® 6000.

- Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux films de polyuréthane, aux mousses ou aux colles acryliques.
- Ne pas utiliser en association avec des solutions iodées ou oxydantes telles que l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène.
- Lumiderm® 6000 peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Ne pas couvrir une plaie par Lumiderm® 6000 durant plus de 30 jours consécutifs.
- Ne pas réutiliser même partiellement car cela peut compromettre la stérilité et la performance du pansement.
- L'intégrité du sachet papier garantit la stérilité de la membrane Lumiderm® 6000.

MODE D'EMPLOI

- Préparation de la plaie
  Nettoyer la plaie, selon les procédures en vigueur. Sécher soigneusement la peau avant application.
- Application du pansement
  1. Choisir une taille appropriée permettant à Lumiderm® 6000 de déborder d'au moins 2 cm des berges de la plaie pour permettre au pansement d'adhérer à la peau saine.
  2. Sortir le pansement stérile de son emballage externe en papier
  3. Le pansement peut être découpé (avec des ciseaux stériles) pour mieux épouser la conformation de la plaie. En cas d'utilisation autour d'un membre, il est préférable que les deux extrémités ne se chevauchent pas.
  4. Repérer la face interne avec papier protecteur de la colle.
  5. Saisir le pansement face papier protecteur sur le dessus et étirer doucement de façon à écarter les 2 berges du papier protecteur au niveau de sa découpe.
  6. Retirer la plus grande partie du papier protecteur en veillant à ne pas toucher la face adhésive avec vos doigts.
  7. Centrer le pansement sur la plaie et l'appliquer avec une légère tension tout en évitant la formation de plis.
  8. Retirer le reste du papier protecteur et lisser les bords pour garantir une bonne adhésion.
- Changement et retrait du pansement
  1. Lumiderm® 6000 peut rester en place jusqu'à 7 jours, selon l'état du patient et le niveau d'exsudat. Au début, il peut être nécessaire de changer le pansement toutes les 24 heures ou selon le rythme préconisé par les bonnes pratiques de traitement des plaies.
  2. Retirer le pansement en le pressant doucement sur la peau avoisinante. Décoller doucement les pourtours du pansement puis étirer soigneusement en soulevant les bords.
  3. Jeter le pansement selon les procédures et la réglementation locale en vigueur.
  4. Si nécessaire, rincer la plaie avec une solution appropriée avant l'application d'un nouveau pansement.

PRÉSENTATIONS

FORMAT	Nombre de pansements par conditionnement	CODE ACL 7	CODE ACL 13
6 cm x 7 cm	2	709 040-8	3401070904088
10 cm x 10 cm	2	660 379-7	3401066037974
10 cm x 10 cm	10	467 951-4	3401046795146
30 cm x 10 cm	2	712 094-8	3401071209489
30 cm x 10 cm	10	467 950-8	3401046795085

CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne pas restériliser.

DISTRIBUTEUR :
ADDMEDICA, 101 rue Saint-Lazare, 75009 PARIS

Fabricant :
Advanced Medical Solutions, Road 3, Winsford Ind. Est.,
Winsford, Cheshire CW7 3PD Royaume Uni

CE 0086
Dispositif médical non inscrit LPPR.